

WSZ-EP-31/653/2015

20 SIE. 2015  
Konin, dn. ....

Wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyposażenia sześciu stanowisk Intensywnej Terapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Dotyczy Pakietu nr 7**

**Zestawienie wymaganych parametrów technicznych:**

1. Dot. pkt. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny fabrycznie nowe myjnie wyprodukowane w 2014r? Pozwoli to na zaoferowanie bardzo atrakcyjnej ceny. Pod względem konstrukcyjnym są one identyczne z modelami z 2015r.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Dot. pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych:

Szerokość: 545 mm

Głębokość: 475 mm

Wysokość: 1.630 mm

Co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki większym wymiarom załadunek odbywa się na ergonomicznej wysokości, a większa komora pozwala na jednoczesne mycie 1 basenu i 2 kacek w jednym cyklu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

3. Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie zasilane prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)? W p. 5 SIWZ Zamawiający wymaga by czas trwania standardowego programu nie przekraczał 10 min. Przy zastosowaniu zasilania 1-fazowego (230V, 50Hz) jest to fizycznie niemożliwe do spełnienia. Prosimy o dopuszczenie zasilania 3-fazowego lub o rezygnację z zapisu p. 5 SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

4. Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy 3,05kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**



5. Dot. pkt. 18- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatyczne otwieranie drzwi? Rozwiązanie takie znacząco podnosi ergonomię obsługi i komfort pracy personelu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

6. Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 5 dysz natryskowych oraz wielodyszową obrotową głowicę natryskową dedykowaną do mycia wnętrza kaczek i basenów? Rozwiązanie takie zapewnia optymalne rezultaty mycia i pod względem funkcjonalnym jest znacznie bardziej efektywne niż zapisane w SIWZ 10 dysz z 2 obrotowymi.

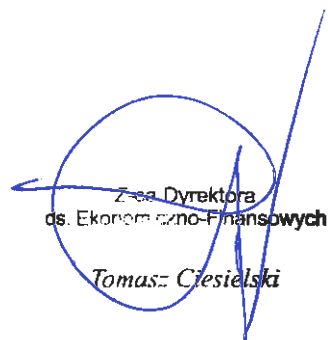
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

### **7. Warunki gwarancji i inne:**

1. Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu p.3 na: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 h – licząc w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?”  
Pozostawienie obecnego zapisu bez zmian powoduje, iż awaria zgłoszona o godz. 16 w sobotę powinna zostać usunięta do godz. 16 w niedzielę, co jest fizycznie niewykonalne.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:**

**„Czas reakcji na zgłoszenie 48 godzin w dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy.”**

  
Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*Tomasz Ciesielski*