

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Informacje

Godziny odwiedzin:

Przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych :

ul. Szpitalna 45 (I piętro) od poniedziałku do soboty w godz. 7.45-10.00

ul. Wyszyńskiego 1 (III piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-10.00

Poza wymienionymi godzinami przyjmowani będą wyłącznie pacjenci ze skierowaniami CITO (pilne)

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POBRANIA KRWI U OSÓB NIEPEŁNOLETNICH - DO 18 ROKU ŻYCIA

1. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia pobranie materiału biologicznego może odbywać się wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Jeżeli opiekunem jest inna osoba niż rodzic dziecka, należy posiadać wypełniony druk:

UPOWAŻNIENIE DO OBECNOŚCI INNEJ OSOBY NIŻ OPIEKUN PRAWNY PRZY
BADANIACH MAŁOLETNIEGO

druk dostępny w ZDL lub na stronie internetowej.

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

Rodzaje badań wykonywanych w ZDL oraz pakietów badań wraz z obowiązującymi cennikami. <https://szpital-konin.pl/cenniki>

- Przygotowanie pacjenta przed pobraniem krwi

- Przygotowanie pacjenta do badania ogólnego moczu

- Dobowa zbiórka moczu

- Przygotowanie pacjenta przed pobieraniem krwi w celu oznaczenia prolaktyny

- Przygotowanie pacjenta do doustnego testu tolerancji glukozy


Co zabrać ze sobą:

Każdy pacjent powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, w przypadku dziecka książeczka zdrowia – pracownik ZDL musi zweryfikować dane pacjenta , nr PESEL).

Uwagi/dodatkowe istotne informacje, które powinny się znaleźć na stronie internetowej:

Każdy pacjent proszony jest o podanie nr telefonu. Jest to niezwykle ważne w przypadku uzyskania wyniku o wartości krytycznej, diagnosta laboratoryjny jest w takim przypadku zobowiązany do kontaktu z pacjentem.

Personel
Kierownik

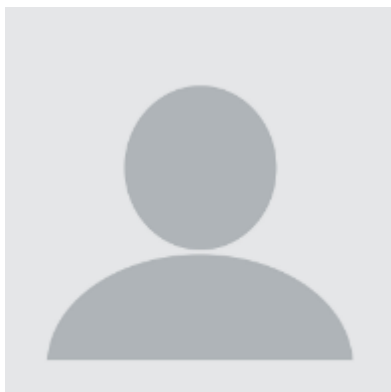

mgr Aneta Adamiak

Kontakt:

Telefon: **63 240 4539**

E-mail: [zdl \[at\] szpital-konin.pl](mailto:zdl@szpital-konin.pl) ([zdl\[at\]szpital-konin\[dot\]pl](mailto:zdl[at]szpital-konin[dot]pl))

Pliki do pobrania

[Regulamin Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej](#) 668.9 KB



[Regulamin Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej](#) Pobierz

RIQAS
Certificate of Participation
COAGULATION PROGRAMME
September 2022 - December 2022

Wojewódzki Szpital Zespólny im. D. Rumanca



Stephen Edwards
RIQAS Manager

Radex International Quality Accredited Scheme
Radex Laboratories Ltd., 11 Elmwood Road, Lutterworth, Leics, Leicestershire LE17 4QZ, United Kingdom

0001234567

The personal information on this certificate has been supplied to the Radex Laboratories Ltd. who are responsible for its content.



RIQAS
Certificate of Participation
COAGULATION PROGRAMME
January 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Krasnie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej



Stephen Edwards
RIQAS Technical Expert

Sally Preece
RIQAS Manager

Radex International Quality Accredited Scheme
Radex Laboratories Ltd., 11 Elmwood Road, Lutterworth, Leics, Leicestershire LE17 4QZ, United Kingdom

001234567

The personal information on this certificate has been supplied to the Radex Laboratories Ltd. who are responsible for its content.



RIQAS
Certificate of Participation
OLYCATED HAEMOGLOBIN PROGRAMME
March 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Krasnie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej



Stephen Edwards
RIQAS Technical Expert

Sally Preece
RIQAS Manager

Radex International Quality Accredited Scheme
Radex Laboratories Ltd., 11 Elmwood Road, Lutterworth, Leics, Leicestershire LE17 4QZ, United Kingdom

001234567

The personal information on this certificate has been supplied to the Radex Laboratories Ltd. who are responsible for its content.



RIQAS
Certificate of Participation
MONTHLY DIMETHOASSAY PROGRAMME
March 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Krasnie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej



Stephen Edwards
RIQAS Technical Expert

Sally Preece
RIQAS Manager

Radex International Quality Accredited Scheme
Radex Laboratories Ltd., 11 Elmwood Road, Lutterworth, Leics, Leicestershire LE17 4QZ, United Kingdom

001234567

The personal information on this certificate has been supplied to the Radex Laboratories Ltd. who are responsible for its content.





Certificate of Participation

MONTHLY CARDIAC PLUS PROGRAMME
March 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Koninie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Stephen Doherty

RIQAS Technical Expert


Julie Pinn

RIQAS Manager



Radex International Quality Improvement Scheme
Radex Laboratory Ltd, 11 Darnley Road, London, UK, London, E12 9JF, United Kingdom

0001-0000

The general information on this certificate has been supplied by the participant and Radex International Ltd takes no responsibility for its content.



Certificate of Participation

SPECIFIC PROTEINS PROGRAMME
March 2023 - August 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Koninie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Stephen Doherty

RIQAS Technical Expert


Julie Pinn

RIQAS Manager



Radex International Quality Improvement Scheme
Radex Laboratory Ltd, 11 Darnley Road, London, UK, London, E12 9JF, United Kingdom

0001-0000

The general information on this certificate has been supplied by the participant and Radex International Ltd takes no responsibility for its content.



Certificate of Participation

IMMUNOASSAY SPECIALITY 3 PROGRAMME
March 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Koninie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Stephen Doherty

RIQAS Technical Expert


Julie Pinn

RIQAS Manager



Radex International Quality Improvement Scheme
Radex Laboratory Ltd, 11 Darnley Road, London, UK, London, E12 9JF, United Kingdom

0001-0000

The general information on this certificate has been supplied by the participant and Radex International Ltd takes no responsibility for its content.



Certificate of Participation

HUMAN URINE PROGRAMME
July 2023 - December 2023

Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. R. Ostrowskiego w Koninie
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


Stephen Doherty

RIQAS Technical Expert


Julie Pinn

RIQAS Manager



Radex International Quality Improvement Scheme
Radex Laboratory Ltd, 11 Darnley Road, London, UK, London, E12 9JF, United Kingdom




0001-0000

The general information on this certificate has been supplied by the participant and Radex International Ltd takes no responsibility for its content.





LABQUALITY i SYSMEX

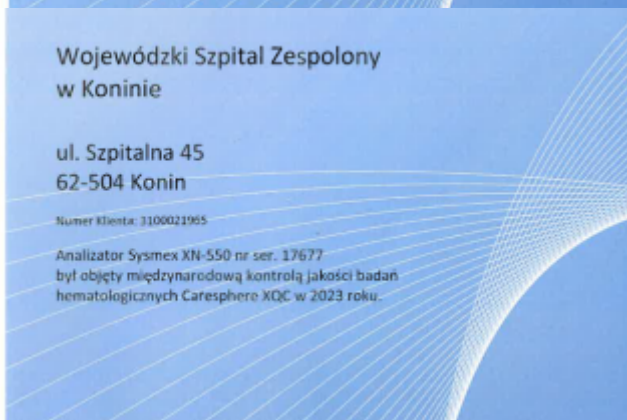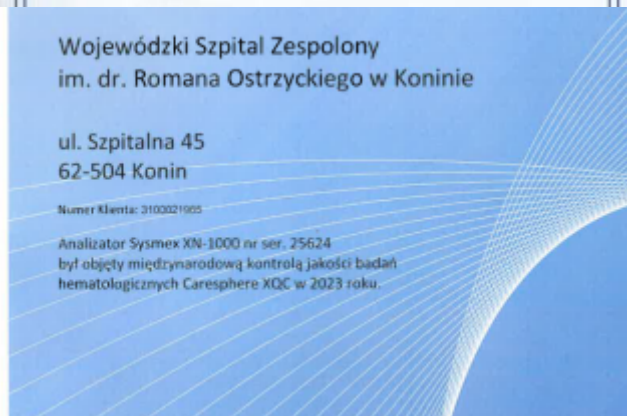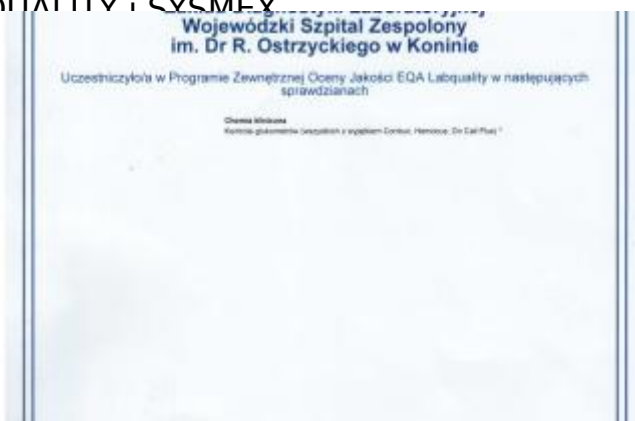

Analizator Sysmex XN-550 nr ser. 12014
był objęty międzynarodową kontrolą jakości badań
hematologicznych Caresphere XQC w 2023 roku.

ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Idol
 Poms
 Wapiti Callosity
 Magnet
 Zulu
 Chiswick
 Budea Callosity
 Mowbray
 Kraynina
 Kaya-Mowbray
 Glacina
 Bilevina Callosity
 Chiswick
 HER-Chiswick
 Triflority
 Anomalous crata Asperginites
 Anomalous crata Altonow
 Fozzina Altonow
 Angitia
 Anomalous crata Altonow

[illegible]

ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Lokalisierung: gesamte ML II

1. Laboratory, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607

Laboratorium wysłało na apurację 03-08-08 w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT (EDICINA)	1. ZEMPA	2. LATO	CUINA (RIGIENA)
pH	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
pH32	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
pH32	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
pH32-alk	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Sal	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Perla	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Chlorid	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Sulph (sulfuric acid)	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Glycerin	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura
Chlorine	(+ + +)	(+ + +)	buono-dura

* + - oznacza porównanie dla analizy w pojedynczej objętości.
 * - - brak wzoru porównawczego dla analizy w pojedynczej objętości.
 Dla wyodrębnienia wzoru porównawczego " + " dla analizy w podzestawie

[illegible]

ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Leukotriene is an enzyme MLD

Laboratory: University of Illinois,
 Urbana, Illinois

Laboratorium uzyskało na apuracji 08-40-07 w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDIČKA	1. MEROVA	2. MEROVN	OCENA ROZNA
Hemoglobin	134 ± 11	134 ± 13	haptično-identično
Hemoglobina	23 ± 10	haptično-identično	
Kreatinil kreatinin (SCr)	64 ± 10	134 ± 13	haptično-identično
Kreatinil kreatinin (SCr)	64 ± 11	134 ± 13	haptično-identično
Kreatinil kreatinin (SCr)	64 ± 11	134 ± 13	haptično-identično
SCr (SCr)	64 ± 11	134 ± 13	haptično-identično
SCr (SCr)	64 ± 11	134 ± 13	haptično-identično
SCr (SCr)	64 ± 11	134 ± 13	haptično-identično

² „+” – osoba pozytywnie dla siebie w pojedynczej ocenie;
³ „-” – brak osoby pozytywnej dla siebie w pojedynczej ocenie;
 Dla wyznaczenia sumy pozytywnej „+” + „-” dla analizy w pojedynczej ocenie.

[illegible]

ul.Szpitalna 45
62-504 Komin

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każde z stycznia 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 4 z 6 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. ZIESEN	OCENA ROCZNA
TSH	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT3	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T3	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
FT4	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T4	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
FT4 (Total)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra

ORZĄDZENIA

"+" - ocena pozytywna dla analizy w przedziale referencyjnym.
"/" - brak oceny pozytywnej dla analizy w przedziale referencyjnym.
Diagnostyka: ocena pozytywna: "+" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena negatywna: "-" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena wątpliwa: "?" dla analizy w przedziale referencyjnym.
N/D - brak danych / nieocena / nieopiniowanie.
Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w trzech materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w dwóch materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "satisfactory" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.
Ocena roczna "pojemna" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.

ul.Szpitalna 45
62-504 Komin

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każde z stycznia 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 4 z 11 analizów ocenianych w programie.

Lośkaticzka oparte MLD

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. ZIESEN	OCENA ROCZNA
Kwas Kwasowy (CK) (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Kwas Kwasowy (CK) (dysprosji)	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Kwas Kwasowy (CK) (dysprosji)	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Trigliceryny T	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Migdalina	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Hemoglobina	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Proteiny (dysprosji) (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Drożdżaki (dysprosji) (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Drożdżaki (dysprosji) (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Wysokość CRP (dysprosji)	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D

ORZĄDZENIA

"+" - ocena pozytywna dla analizy w przedziale referencyjnym.
"/" - brak oceny pozytywnej dla analizy w przedziale referencyjnym.
Diagnostyka: ocena pozytywna: "+" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena negatywna: "-" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena wątpliwa: "?" dla analizy w przedziale referencyjnym.
N/D - brak danych / nieocena / nieopiniowanie.
Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w trzech materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w dwóch materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "satisfactory" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.
Ocena roczna "pojemna" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.

ul.Szpitalna 45
62-504 Komin

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każde z stycznia 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 21 z 32 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. LATO	OCENA ROCZNA	ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. LATO	OCENA ROCZNA
Testy	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	ATP	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT3	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CEA	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
TSH	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CA 125	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT4	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	CA 15-3	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T3	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D	CA 19-9	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
FT4	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	PSA (Total)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
T4	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D	PSA (Free)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Hemoglobin (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Dysprosji	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Hemoglobin (dysprosji)	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D	Proteiny	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
HCG Total (dysprosji)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Karbowodowod	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Kortyzol	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Kwas foliowy	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Proteiny	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D	Kwas waleryanowy	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Proteiny	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	VB12	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Testosteron	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	Proteiny	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Insulina	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	lgf, całkowite	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D
Parathormon (PTH)	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra	E-2-siekajacych	(0) (0) N/D	(0) (0) N/D	N/D

ORZĄDZENIA

"+" - ocena pozytywna dla analizy w przedziale referencyjnym.
"/" - brak oceny pozytywnej dla analizy w przedziale referencyjnym.
Diagnostyka: ocena pozytywna: "+" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena negatywna: "-" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena wątpliwa: "?" dla analizy w przedziale referencyjnym.
N/D - brak danych / nieocena / nieopiniowanie.
Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w trzech materiałach kontrolnych.

ul.Szpitalna 45
62-504 Komin

w 2023 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii poszerzonej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każde z stycznia 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 5 z 5 analizów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. WIOSNA	2. LATO	OCENA ROCZNA
PT sokalnik	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
PT INR	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
APTT współczynnik	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
TT współczynnik	(+ +) +	(+ +) +	dobra
Fibrinogen	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra

ORZĄDZENIA

"+" - ocena pozytywna dla analizy w przedziale referencyjnym.
"/" - brak oceny pozytywnej dla analizy w przedziale referencyjnym.
Diagnostyka: ocena pozytywna: "+" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena negatywna: "-" dla analizy w przedziale referencyjnym; ocena wątpliwa: "?" dla analizy w przedziale referencyjnym.
N/D - brak danych / nieocena / nieopiniowanie.
Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w trzech materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w dwóch materiałach kontrolnych.
Ocena roczna "satisfactory" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.
Ocena roczna "pojemna" - kryteria dopuszczalnego błędów dla przedziału wartości referencyjnych w jednym materiale kontrolnym.