

Konin, 08.09.2020r.

WSZ-EP-35/1101/2020

Wg rozdzielnika**Wyjaśnienia do SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, serwet operacyjnych, masek, czepków chirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-35/2020).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o składzie:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m², odporność na przenikanie płynów 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 108kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do kraniotomii o składzie:


- 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów.
- 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,
- 1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,
- 2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serwety obłożeniowe wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasę palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii brzusznej o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m, odporność na przenikanie płynów 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 108kPa.

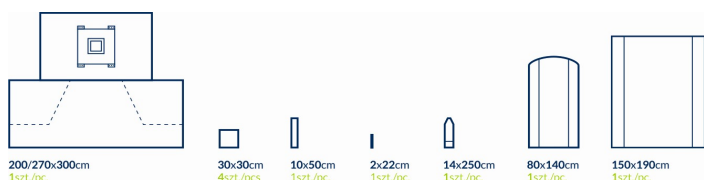

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 5, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej o długości troków 40 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski chirurgicznej spełniającej normę EN 14683 w typie II R?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 8, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm +/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 8, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 8, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany. W części bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość 10 cm +/- 1cm. Wymiary denka: 23cm x 19 cm. Szyty techniką overlok. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka w opakowaniu handlowym a'100szt, kolor niebiesko/biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 9, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m², denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m², oddychający. Wysokość



czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 9, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 10, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z peanem metalowym j.u. o długości 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z serwetą główną zabiegową z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², z centralnym otworem przyklepnym 6 x 8 cm, odporność na przenikanie cieczy 120 H₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z kompresami z podwijanymi brzegami, składanie typu ES?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych z osłoną stolika zabiegowego 75 x 90 cm bez wzmocnienia, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 12A, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetkę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 12A, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12B, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z owinięciem w serwetkę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 12B, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z jedyną, aktualną normą EN 13795-1:2019? Pozostałe wydania normy przestały obowiązywać w październiku 2019, w związku z tym oferowanie produktów zgodnych z normą EN 13795:2013 lub EN 13795:2010 jest niezgodne z aktualnymi wymogami prawnymi. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego spełnianie normy EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 15, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wzmocnionego 8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 15, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wzmocnionego 8 lub 48 nitkami o gramaturze 40g/m² i rozmiarze 80 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 16, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca ogrzewającego jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Pakiet nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodne z opisem.

W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.


Pakiet 20, pozycja 1 -Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m² (zamiast 42g/m²), oraz 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² (zamiast włókniny chłonnej o gramaturze 30g/m²), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m²(zamiast 72 g/m²). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 21, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

- 1 x serweta górna samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x 60 cm
- 2 x serwety boczne samoprzylepne o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta dolna samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wym. 25 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie o wym. 60 x 85 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

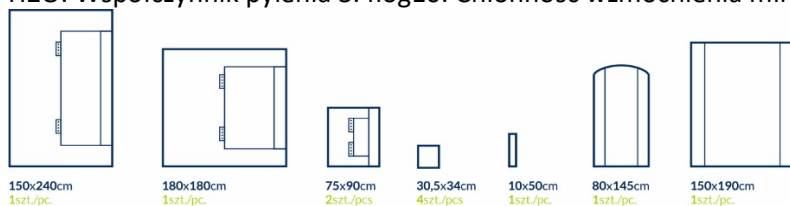


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

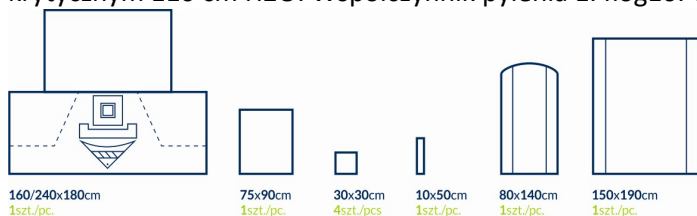

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie rozciągniętym 105 x 105 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 23, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 23, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie rozciągniętym 65 x 85 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 23, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną na aparaturę w rozmiarze w stanie rozciągniętym 85 x 85 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stół Mayo wykonaną z mocnej folii o gramaturze 50g/m² z włókninową warstwą chłonną o gramaturze 30g/m², wzmocnienie 60 x 140 cm, rozmiar całkowity 80 x 140 cm. Odporność na penetrację płynów 140 cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho 130kPa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 27, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną o wymiarze 10 x 50 cm, wykonaną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 27, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m², oraz folii PE 25 µm. Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa. W zestawie 1 szt taśmy lepnej do zamoacowania osłony.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści nogawice chirurgiczne o wymiarach 70 x 120 cm wykonane z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H₂O?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 3 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy należy podać wycenę za szt, czy za zestaw?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 27, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną o wymiarach 30 x 40 cm, wykonaną z transparentnej folii PE o grubości 0,065 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych podstawowych z serwetą na stół Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 47 g/m² (zamiast 42g/m²), oraz 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² (zamiast włókniny chłonnej o gramaturze 30g/m²), łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104g/m²(zamiast 72 g/m²). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

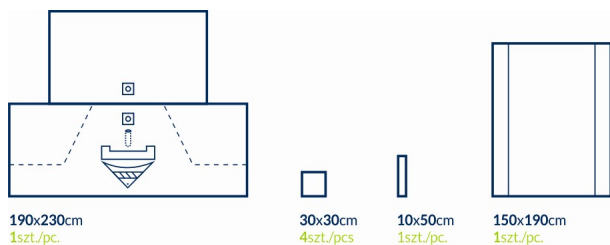

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.


Pakiet 30, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
- 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L
- 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m², wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x

140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

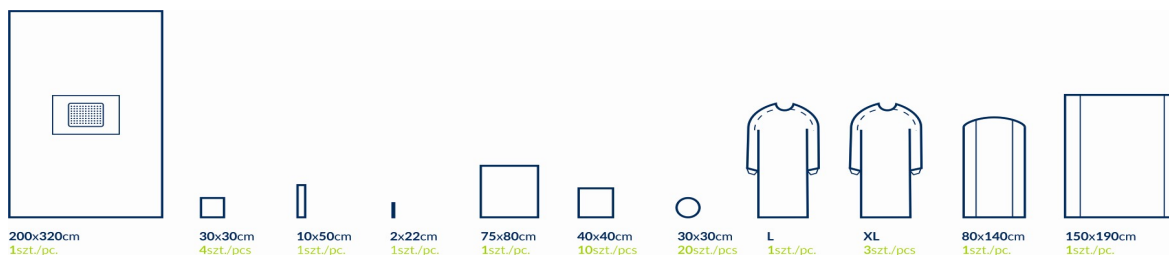

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 31,32, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową 3 warstwową (włókna 28 g/m², folia PE 25 g/m², polipropylen 22g/m²). Odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, na mokro 95 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 33, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze włókniny 30g/m² oraz folii PE 30g/m². Opakowanie jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 34,35, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową 3 warstwową wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m² + wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 205,6 kPa, na mokro 199,4 kPa. Opakowanie jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 34, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową w rozmiarze 120 x 170 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 12 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 35, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową w rozmiarze 200 x 280 cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 36, 37, 38, 42 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę zabiegową wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze włókniny 30g/m² oraz folii PE 30g/m². Opakowanie jednostkowe posiada 4 samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 39 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę samoprzylepną o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne w rozmiarze 75 x 100 cm o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Opakowanie jednostkowe wyposażone w 4 etykiety samoprzylepne do wklejenia do protokołu. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stół instrumentariuszki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 41, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń wykonaną z folii PE o grubości 0,065 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 42, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm? Opakowanie zbiorcze: 2 mniejsze kartony wewnętrzne oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar serwety oraz opakowanie zbiorcze, natomiast Zamawiający nie dopuszcza wymienionego otworu. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z serwetą na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną w rozmiarze 65 x 190 cm (zamiast 75 x 190 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30 x 30 cm (zamiast 18 x 25 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych fartuchem chirurgicznym o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm, włóknina wiskozowa 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z foliowym opatrunkiem z wkładem chłonnym w części środkowej, posiada trójstopniowy system aplikacji, rozmiar 6 x 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z taśmą typu velcro w rozmiarze 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych ze skalpelem bezpiecznym z wysuwającym ostrzem 15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z zestawem przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych dodawany osobno do zestawu w foliowej kopercie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z osłoną na kamerę w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z drenem z końcówką yankauer CH21, kontrola siły ssania, 4 otwory boczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z kieszenią dwudzielną w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji laparoskopowych z serwetą do zabiegów laparoskopowych w rozmiarze 200/270 x 300 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, otwór samoprzylepny 25 x 30 cm, dodatkowe wzmocnienie wokół otworu, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z serwetą chirurgiczną (poz. 1 w zestawie) z przylepcem, o wzmocnieniu 25 x 60 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego serwetą chirurgiczną (poz. 2 w zestawie) z laminatu 2 warstwowego, 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, odporność na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z serwetą chirurgiczną (poz. 3 w zestawie) w rozmiarze 180 x 180 cm, laminat 2 warstwowy, 60g/m², odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, odporność na wypychanie sucho/mokro 110/100 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z opatrunkiem chłonnym w rozmiarze 10 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z drenem łączącym do ssaka (poz. 7 w zestawie) CH 24, 3 metry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z taśmą typu velcro w rozmiarze 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego ze strzykawką 3 częściową (poz. 11 w zestawie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z kieszenią foliową w rozmiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 51, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego z osłoną na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 260 cm z warstwą chłonną 65 x 260 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny nie zawierający pętli silikonowej chirurgicznej MAXI (pozycja 1 w zestawie)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z serwetą na ekran anestezjologiczny w rozmiarze 150 x 240 cm z przyklepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z serwetami w pozycji 3 i 4 wykończonymi taśmą lepłą o wymiarach 5 x 85 cm, serwety o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z ostrzem 15 lub 20 (w miejsce ostrza 18)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z osłoną z tworzywa sztucznego (pozycja 8 w zestawie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z taśmą lepłą w rozmiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 55, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przepukliny z osłoną na stół narzędziowy z warstwą chłonną o wymiarach 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetą na ekran anestezjologiczny w rozmiarze 150 x 240 cm z przyklepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetami z pozycji 2 i 3 z taśmą lepłą 5 x 85 cm, laminat dwuwarstwowy, serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z ostrzem chirurgicznym 15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z osłona z tworzywa sztucznego (poz. 7 w zestawie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji pęcherzyka z osłona na stół narzędziowy z warstwą chłonną 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z drenem redona 70 cm (zamiast 50 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z obłożeniem chirurgicznym (poz. 3 w zestawie) 150 x 200 cm, wycięcie U o wymiarach 6 x 65 cm, trójwarstwowy SMS, gramatura 50g/m², wzmocniona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z serwetą operacyjną (poz. 4 w zestawie) 150 x 240 cm z przyklepcem, laminat dwuwarstwowy 60g/m², dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m², laminat 2-warstwowy, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z osłoną na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 260, obszar chłonny 65 x 260 cm, laminat 2-warstwowy, gramatura 80g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z zestawem osłon na ramię C, 100 x 160 cm + 80 x 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z taśmą lepną 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z osłoną na kończyne 30 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 58, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji ramienia z ostrzem nr 15 lub 20 (zamiast 18)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z podkładem syntetycznym pod gips 10 cm x 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z serwetą chirurgiczną 150 x 240 cm, dwuwarstwowa, gramatura 60g/m² (poz. 2 w zestawie)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z serwetą na ekran anestezjologiczny 150 x 240 cm z przyłepcem, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z serwetami w pozycji 4 i 5 z taśmą lepną 5 x 85 cm, laminat dwuwarstwowy, gramatura 60g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z osłoną na stół narzędziowy 150 x 190 z warstwą chłonną 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z zestawem osłon na ramię C, 100 x 160 cm + 80 x 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z taśmą lepłą 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z fartuchem o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 59, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji przedramienia z ostrzem 15 lub 20 (zamiast 18)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z osłoną na stół narzędziowy z obszarem chłonny 75 x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z osłoną na kamerę z perforacją, w rozmiarze 16 x 250 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z taśmą typu rzep 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z serwetą (pozycja 4 w zestawie) 190 x 230 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o średnicy 6 cm, i otworem brzuszny 6 cm, dodatkowo osłona palca do badania per rectum. Serweta również zintegrowana z torba do zbiórki płynów, wykonana trzywarstwowego materiału SMS o gramaturze 50g/m², odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 205,6/199,4 kPa, górna część serwety wykonana z nieprzemakalnej folii PE, chłonność 680%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z fartuchem z pozycji 5 zestawu o odporności na przenikanie cieczy 50,47 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 200/179,3 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z fartuchem endoskopowym z pozycji 6 zestawu wykonanym z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony laminatem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR z drenem CH 24, 5,60 x 8,00 mm, długość 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 60, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR bez zestawu do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) – pozycja 8 zestawu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii zapakowany w torbę foliową ze wstawką Tyvek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z nazwą zestawu umieszczoną na etykiecie głównej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii bez ubrania operacyjnego w rozmiarze L i M?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z ręcznikami papierowymi w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z fartuchami o standardowym, prostym kroju rękawów, zapewniającym swobodę ruchów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z powłoką ochronną 80 x 150 cm typu walec, wyposażona w gumkę wzdłuż krótszego boku (w miejsce powłoki ochronnej 160 x 30 cm typu torba, elastyczna krawędź na dłuższym boku)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z kleszczykami metalowymi zakrzywionymi o długości 12,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z igłą 0,8 x 40 mm 21G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z kleszczykami plastikowymi Kocher/Pean 14cm (w miejsce kleszczyków do chusty czerwonych)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z miskami niebieskimi nietransparentnymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z chustą angiograficzną 220cm x 320cm z dwoma otworami o średnicy 10cm, wzmocnienie w strefie krytycznej 50cm x 80cm, serweta wyposażona obustronnie w foliowe przezroczyste wstawki 60cm x 320cm zabezpieczające panel sterowniczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z torebką na płyny 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 65, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do angiografii z serwetą na stolik do instrumentarium (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150 x 190 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 66, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch urologiczny fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rozmiar XXL. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 69, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania operacyjnego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. W związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy), który Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na <https://platformazakupowa.pl>.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządziła: R. Janik